

Nr. 40527/15.07.2021

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

1. Autoritatea contractantă:

**Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu”, Cod fiscal 4663448, Bd. Liviu Rebreanu nr. 156, cod postal 300736, Timișoara, telefon/fax 0356/433114;**

2. Tipul și durata contractului pentru care sunt solicitate oferte: **Contract de furnizare, valabilitate 3 luni;**

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de prestări de servicii: **Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;**

4. Natura produselor care se vor achiziționa, codul CPV, valoarea estimată a contractului:

- **Componente echipamente radiologie**
- **Cod CPV 31671200-2 - „TUBURI CATODICE”**

**Valoare estimată: 273.500,00 lei, exclusiv TVA, determinată, după cum urmează:**

Nr. Lot	Denumire produs	U.M.	Cantitate totală	PU estimat	VALOARE TOTALA (fara TVA)
				Ron	
1	CUPOLA RX tip CRT 2150 echipata cu tub radiogen tip DU 5008 C	buc	1	273.500,00	273.500,00
Valoarea totală, LEI, exclusiv TVA					273.500,00

5. Oferta va conține:

- **Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:** Se va completa o declarație pe propria răspundere de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

- **Propunerea tehnică** (se vor respecta cerințele minime din caietul de sarcini și va include descrierea specificațiilor tehnice care să poată fi corelată cu ușurință cu specificațiile solicitate)

- **Propunerea financiară** (formular de oferta și centralizator) - va fi exprimată în lei, fără TVA, cu două zecimale. Valoarea comparată este cea fără TVA/lot.

6. Se interzice depunerea de oferte alternative.
7. a) Termenul limită de primire a ofertei: **16.07.2021, ora 12:00; oferta transmisă va fi cea finală.**
- b) Adresa la care trebuie transmisă oferta: pe e-mail, la adresa [tatiana.sinoi@hosptm.ro](mailto:tatiana.sinoi@hosptm.ro)
- c) Limba în care trebuie redactată oferta: română.
8. Modalități principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează: Surse proprii
9. Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: **90 de zile** de la data de deschidere a ofertei.
10. Termen de livrare: **48 de ore** de la transmiterea comenzii ferme a achizitorului.
11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut** pentru lotul 1.

Atasam prezentei: Caietele de sarcini

**Manager**

**Asist. Univ. Dr. Raul Pătrașcu**





**Șef Serviciu Achiziție**  
**Ing. Muntean Cosmin**

**Contractare**

**Șef Birou Achiziție Publice**  
**Ing. Pește**

Întocmit,  
Tatiana Sinoi



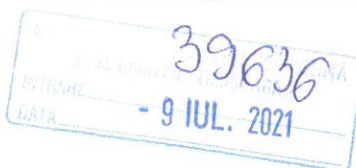

## Caiet de sarcini

pentru achiziționare cupolă Rx tip CTR 2150 echipată cu tub radiogen tip DU 5008 C

La achiziționarea unei cupole Rx tip CTR 2150 echipată cu tub radiogen tip DU 5008 C, necesară pentru instalația radiologică Computer Tomograf NeuViz 16 Essence trebuie să se țină cont de următoarele specificații tehnice:

Nr.crt.	Denumire criteriu	Specificații tehnice
1.	Materialul anodei	TZM,W,Re,Grafit
2.	Valoarea maximă de încălzire a anodei	3,8 MJ - 5,3 MHU
3.	Valoarea maximă de disipare a căldurii anodei	9,6 kW - 815 kHU/min
4.	Diametrul discului anodei	190 mm
5.	Unghiul anodei	7°
6.	Unghiul util al fasciculului	$\pm 2,75^\circ / \pm 27,2^\circ$
7.	Timpul nominal de accelerare	20 s
8.	Viteza nominală de accelerație	6300 RPM
9.	Curentul maxim al filamentului	5,2 A
10.	Tensiunea maximă a filamentului	16 V
11.	Curentul filamentului în standby	$2,8 \pm 0,5$ A
12.	Tensiunea nominală a Tubului Rx	140 kV
13.	Putere focar mic	36 kW
14.	Putere focar mare	50 kW
15.	Filtrarea permanentă	0,5 mmAl/75 kV IEC 60522/1999
16.	Filtrarea adițională	2,0 mm Al/75 kV/HVL 2,5 mm Al
17.	Filtrarea totală	2,5 mm Al / 75 kV
18.	SID	10 cm x 103 cm
19.	Greutatea	$96,6 \pm 0,9$ kg

Tehnician Principal de Radiologie  
și Imagistică Medicală licențiat  
Bărbulescu, Marinela

