

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156. Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 466956
• e-mail: judelean@hospin.ro • www.hospr.ro



SECȚIA BLOC OPERATOR 1

32604/13.07.2025

Prof.Univ.Dr. SANDESC DOREL



CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE PENTRU NEGOCIERE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.


Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii și furnizări ale produselor (după caz).

- Protecția muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protecția mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestor proceduri, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respective Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se considera de către Ofertant că aceasta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4363448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hospiti.ro • www.hospiti.ro



2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreană precum Prof. Dr. Pius Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilescu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și înnoirii noastre a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standarde stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. Încadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPB privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespondă calitativ specificărilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria *material sanitar*




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: pbrînzeu@hospit.ro • www.hospit.ro



3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea material sanitar



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.2.1 Produse solicitate

Locul de livrare: Sediul Autorității Contractante: Bd Liviu Rebreanu 156

Termen de livrare maxim 30 de zile de la emiterea comenzii

Lot	Denumire	U.M.	Cantitate necesara lunară	Pret Estimativ /buc(factura TVA)	Pret total estimat	Specificatii Tehnice Solicitam mostre
1.	Pensa pentru sigilare vasculara 440mm	Buc	48	1765	84720	Uz laparoscopic, diam. 5mm, lungime 440mm, ambalare sterila, 6pense/cutie ; - compresie egala a tesutului pe toata suprafata activa a pensei ; - partea activa a pensei, cea de jos, sa fie prevazuta cu articulatie care sa permita inchiderea incepand de la varf ; - extindere termica laterala de maxim 1mm - pensa sa fie prevazuta cu maner de rotatie la 360 grade si buton de actionare de tip "one touch" - design ergonomic, prevazut cu sistem de mentinere a pensei pe pozitia inchis ; - taierea la rece sa se faca cu lama cu varf tip "V", in momentul actionarii manuale - lungime suprafata sigilare vasculara de 26,5MM - lungime suprafata taiere de 23,5MM



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



						- compatibila cu sistem de sigilare vasculara Aesculap Lektrafuse
2.	Clipuri polimer HemOLock L	Buc	480	15	7200	Clipuri polimer HemOLock marime L, culoare mov, sterile, marcaj CE
3.	Clipuri polimer HemOLock XL	Buc	840	15	12600	Clipuri polimer HemOLock marime XL, culoare aurie, sterile, marcaj CE
4.	Set steril cistoscopie pentru endoscopia urologica inalta	Buc	480	119	57239	Compus din: 1 bucata camp pentru masa de instrumente, confectionat din material bistratificat, dimensiune minim 100 cm x 150 cm 1 bucata camp de cistoscopie cu orificiu genital autoadeziv minim 7 cm, dimensiune camp minim 75 cm x 200 cm 1 bucata camp chirurgical bistratificat, dimensiune minim 90 cm x 75 cm 2 bucati acoperitoare picioare dimensiuni minim 75 cm x 140 cm 1 bucata husa de protectie cabluri video cu dimensiunea de minim 13 cm x 250 cm 2 bucati servetele de celuloza cu dimensiunea 30 x 33 cm 1 bucata halat chirurgical dublat mar. XL Specificatii material campuri si acoperitoare: Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu se dezlipi, greutate minim 90 g/m². - Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germeni - Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser. - Câmpurile sa fie clasificate in clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate - Se vor prezenta rapoarte /confirmari de testare , original si traducere autorizata in lb romana Specificatii Halat chirurgical: - ranforsat pe maneci si piept, de la gat la baza halatului, ranforsare



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663449 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



						frontala minim 50X 100 cm - tip material: laminat tip polipropilena netesuta - repelent la lichide - halatul are sistem de prindere cu banda velcro , combinata cu zone adeziva di propilena lipita , pentru reglarea la gat a halatului chirurgical , pe orice portiune din spatele gatului si carton d e ghidaj - cu mansete elastice - nu contine fibra de sticla si latex, filtreaza bacterile, neiritant, hipoalergenic - Zonele ranforsate sa fie repelente la alcool -minim clasa 9, NWSP 080.8(2005) - sa fie rezistent ignifug clasa I conform 16 CFR Part 1610 - standard pentru flamabilitate imbracaminte textila -Se vor prezenta rapoarte /confirmari de testare , original si traducere autorizata in lb romana - lungime totala minim 140 cm, latimea minim 165 cm, lungime maneca min 87 cm (ranforsata minim 40 cm) - material netesut, ignifug, impermeabil pentru lichide, permeabil pentru aer, cu strat intermediar din microfibre, rezistent la frecare, cu mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor, cu o scămoșare redusă și rezistent la abraziune. - sa prezinte marcaj CE conform regulamentului UE 2017/745 - ambalat impreuna cu prosoape de hartie. Husa de protectie: - Husa de acoperire cabluri din tub film de polietilena, transparent - Husa sa fie impaturita telescopic si sa prezinte un carton de ghidaj si banda adeziva la capat pentru aplicate si fixare facila; ambalata individual steril in folie termosudata. - Dimensiuni: lungime min 2.5m, latime min 13cm
--	--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



						Toate componentele sunt sterile, sterilizare cu oxid de etilena. Ambalate in punga sterila termosudata. Produsele sa fie clasificate ca dispozitive medicale clasa I steril. Ambalajul individual are inscriptionate: codul produsului, valabilitatea, mod de sterilizare, marca CE, producatorul. Sa prezinte eticheta dubla autoadeziva, detasabila, pentru urmarirea circuitului produsului Produsele sa poarte marcaj CE conform Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale. Valabilitate: 5 ani de la data producerii
5.	Set nefroscopie	Buc	100	136	13600	-1 buc CAMP PENTRU MASA DE INSTRUMENTE RANFORSAT cu dimensiunea de min 150 X 190 CM. MATERIAL LAMINAT -1 buc CAMP CU APERTURA AUTOADEZIVA cu dimensiunea de 20 X 15 CM. SI SAC COLECTOR CU EVACUARE - DOUA BENZI ADEZIVE cu dimensiunea de MINIM 170 X 300 CM. - 1 buc HUSA PROTECTIE CABLURI VIDEO cu dimensiunea de min 13 x 250 cm -2 buc SERVETELE CELULOZA cu dimensiunea de 30 X 30 CM -1 buc HALAT CHIRURGICAL UROLOGIE ULTRARANFORSAT MARIMEA XL RANFORSAT IN ZONA PIEPTULUI SI A BRATELOR PE TOATA LUNGIMEA Specificatii material campuri si acoperitoare: Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu se dezlipi, greutate minim 90 g/m². - Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germeni - Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser.




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0358 433111 • Fax +4 0253 486956
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



					- Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate - Se vor prezenta rapoarte /confirmari de testare , original si traducere autorizata in lb romana - Specificatii Halat chirurgical: - Ultraranforsta pe toatya lungimea manecilor prin laminare in trei straturi 65 g/m2 - tip material: laminat tip polipropilena netesuta - Folie de polietilena in zona corpului 47 g/m2 - repelent la lichide - halatul are sistem de prindere cu snur si carton de ghidaj - cu mansete elastice - nu contine fibra de sticla si latex, filtreaza bacterile, neiritant, hipoalergenic - - sa fie rezistent ignifug clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - standard pentru flamabilitate imbracaminte textila - Se vor prezenta rapoarte /confirmari de testare , original si traducere autorizata in lb romana - lungime totala minim 150 cm, latimea minim 200 cm, lungime maneca min 88 cm (ultra ranforsata integral) - material netesut, ignifug, impermeabil pentru lichide, permeabil pentru aer, cu strat intermediar din microfibre, rezistent la frecare, cu mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor, cu o scămoșare redusă și rezistent la abraziune. - sa prezinte marcaj CE conform Regulamentului UE 2017/745 - ambalat impreuna cu prosoape de hartie. Husa de protectie: - Husa de acoperire cabluri din tub film de polietilena, transparent - Husa sa fie impaturita telescopic si sa prezinte un carton de ghidaj si
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



						banda adeziva la capat pentru aplicate si fixare facila; ambalata individual steril in folie termosudata. - Dimensiuni: lungime min 2.5m, latime min 13cm Toate componentele sunt sterile, sterilizare cu oxid de etilena. Ambalate in punga sterila termosudata. Produsele sa fie clasificate ca dispozitive medicale clasa I steril. Ambalajul individual are inscriptionate: codul produsului, valabilitatea, mod de sterilizare, marca CE, producatorul. Sa prezinte eticheta dubla autoadeziva, detasabila, pentru urmarirea circuitului produsului Produsele sa poarte marcaj CE conform Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale. Valabilitate: 5 ani de la data producerii
6.	Sonda Dormia tip NGage	Buc	15	1100	16500	Sonde pentru extragerea calculilor la ureterscopie flexibila 1.7Fr - 2,2Fr, cosulet minim 11mm, lungime 120cm, cos cu 4 fire cu deschidere sub forma ce con , fir si cos din nitinol ce permit revenirea la forma initiala, cos fara varf (tipless). Sa aibe adaptor Tuohy-Borst inclus, Produs CE, steril.
7.	Set stent ureteral JJ tumoral CH 7 26cm	Buc	2	390	1950	Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ ramforsat metalic, de termen lung, impingator, fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic - Stent ureteral JJ - specialitate pentru TUMORI- fabricat din poliuretan autostatic special medical, ramforsat metalic, marcat, gauri pe lungime, antialergic, gauri la capete si pe lungime, radioopac, ambele capete deschise, CH 7, cu lungimea de 26 cm, - termen implant minim la 10 luni;




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



						- firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035" - eticheta pacient/fisa/doctor. produs CE, garantie minim 2 ani, steril, marcat pe ambalaj
8.	Set stent ureteral termen lung JJ CH 8 26cm	Buc	40	300	12000	Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ, impingator, fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac, tratat cu substante care reduc riscul de incrustare; - un singur capat sa fie cofilat, celalat drept - lungimile cateterelor JJ sa fie de 26cm; - firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035" - termen implant minim la 10 luni; - eticheta pacient/fisa/doctor. produs CE, garantie minim 2 ani, steril, marcat pe ambalaj
9.	Kit steril unica utilizare chirurgie spinala	Buc	100	263	26300	<u>Continut kit:</u> 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente 150 x 190 cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayo 80 x 145 cm 1 camp spinal ranforsat 260 x 320 cm cu orificiu de 9 x 22 cm, prevazut cu banda velcro 1 bandă autoadezivă 10 x 50 cm 4 șervețele de celuloză 30 x 30 cm 4 campuri autoadezive bistratificate, min. 50 x 50 cm 20 comprese din material netesut cu fir radioopac 3 straturi, culoare alba, 10 x 10 cm 1 halat chirurgical dublat mar. L 3 halate chirurgicale extraranforsate, cu masca cu legaturi integrata



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 3356 433111 • Fax +4 0256 466956
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					mar. XL 1 electrocauter, cu 2 butoane, min. 450 cm 1 pansament postoperator cu corp absorbant și strat de silicon 15 x 8cm <u>Specificatii material camp masa instrumente ranforsat:</u> - Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m². - Film: polietilena 60 μm - Nețesut: polipropilena netesuta 30 g/m² - Îmbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic - Fără latex - Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată: - o Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 lb - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2 Log₁₀ - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 185 cm (H2O) - o Rezistența la plesnire – umed – minim 80 kPa - o Rezistența la plesnire – uscată – minim 85 kPa - o Rezistența la întindere – uscată – minim 30 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal - o Rezistența la întindere – umedă – minim 35 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal - Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată: - o Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 lb - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) - o Rezistența la plesnire – umed – minim 190 kPa - o Rezistența la plesnire – uscată – minim 200 kPa - o Rezistența la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



						○ Rezistența la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal <u>Specificatii material camp Mayo:</u> - Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m². - Nețesut: PP hidrofil, 30 g/m² - Film: polietilena 60 μm - Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic - Fără latex - Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranforsa: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B ○ Curatenia – microbiana – STERIL ○ Scămoșare – maxim 1.5 Log₁₀ ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 80 cm (H2O) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 75 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 35 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal ○ Rezistența la întindere – umedă – minim 40 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal - Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsa: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B ○ Curatenia – microbiana – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal ○ Rezistența la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal
--	--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



					<u>Specificatii material campuri bistratificate:</u> - Compozitie: Film neșut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m², - Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond), minim 30 g/m² - Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate si bacterii - Cele doua straturi sa fie imbinat termic - Fără latex - Caracteristici si parametri de performanta: - o Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 Ig - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa - o Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal - o Rezistența la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal - o Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² <u>Specificatii material campuri ranforsate:</u> • Compozitie: Film neșut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + Absorbant- intaritura minim 55 g/m² • Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m² • Material întăritura: SMS hidrofilic neșut • Neșut; Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond) • Film: polietilenă compact • Straturile sa fie imbinat termic
--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judolean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					• Fără latex • Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranfarsata: ○ Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 I B ○ Curatenia – microbiana – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2.5 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H20) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal ○ Rezistența la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² • Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranfarsata: ○ Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 I B ○ Curatenia – microbiana – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H20) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 335 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal ○ Rezistența la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m² Materialul câmpurilor sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanta „Performanta inalta, zona critica”. Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser.
--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 480966
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



					Campurile sa fie clasificate in clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate Materialul trebuie sa fie impermeabil la lichide si germeni, sa se muleze usor pe corpul pacientului, sa aiba proprietati anti-statice, sa nu contina latex (pentru a nu provoca alergii). Campurile trebuie sa fie marcate cu pictograme care sa indice zona de aplicare, pentru a fi usor de manevrat si a scurta durata de izolare. <u>Specificatii comprese din material netesut cu fir radioopac:</u> - Intre doua straturi de material netesut (70% vascoza si 30% polyester) sa fie amplasat un strat de plasa de poliamida/polyester pentru marirea rezistentei. - Straturile exterioare sa fie incetite pentru marirea capacitatii de absorbție. - Sa contina fir radioopac cu continut de sulfat de bariu minim 60% - Sa nu contina: latex, PVC, plastifianti alternativi, colofonie, Clor, Bisphenol A, materii prime de origine animala, substante toxice. - Scamosare foarte scazuta, sa nu prezinte fire desprinse. - Sa prezinte ISO 10993 pentru evaluarea biologica a dispozitivelor medicale si EN ISO 14971-managementul riscului privind dispozitivele medicale. - Sa fie testate in conformitate cu EN 1644-1 - o Capacitate retenție a lichidelor sa fie de min. 12 g/g, iar dupa 30 minute de imersare la 37 grade C, 15 g/cm - o Dimensiune: 10 x 10cm; - o PH neutru <u>Specificatii halat chirurgical dublat, mar. L</u> • Halat chirurgical ranforsat din material netesut, ignifug, repelent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre; cu o mare rezistență la
--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



					penetrarea fluidelor și a bacteriilor. • Scămoșare redusă și rezistent la abraziune. • Manșete elastice lungi și tricotate din poliester. • Sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și parte adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice porțiune din jurul gâtului. • Suprapunere extra largă la spate. • Guler colorat pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție. • Materialul halatului sa respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. • Zonele ranforsate sa fie repelente la alcool – minim clasa 9, NWSP 080.8.R0 (20) • Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate îmbrăcăminte textilă. • Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu. • Material: ○ Nețesut: Polipropilenă-material nețesut (SMS), minim 40g/m² antistatic ○ Ranforsare: material laminat din pelicula netesută PP-PE în partea din față și pe brate, minim 42 g/m² ○ Manșete - 100% Poliester ○ Fir cusătură - 100% Poliester • Caracteristici în zona neranforsată: ○ Rezistența la penetrare microbiană – minim 3 IB ○ Puritate – microbiană – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie ≤ 2,5 IPM ○ Scămoșare – maxim 2.5 log10 ○ Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 40cm H₂O ○ Rezistența la rupere – Uscat – minim 138 kPa ○ Rezistența la rupere – Umed – minim 137 kPa
--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara

• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486355

• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



					○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 103 N, transversal minim 40 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 105 N, transversal minim 40 N • Caracteristici în zonele cu ranforsare: ○ Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 IB ○ Puritate – microbiană – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2 log10 ○ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 160 cm H₂O ○ Rezistență la rupere – Uscat – minim 300 kPa ○ Rezistență la rupere – Umed – minim 215 kPa ○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 140 N, transversal minim 84 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 137 N, transversal minim 80 N • Dimensiune: L - lungime: 125 cm, circumferință: 157 cm (ranforsare 90 x 50cm), lungime maneca: 80 cm (ranforsare 40cm) • Sa prezinte marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale <u>Specificatii halat chirurgical extraranforsat, cu masca cu legaturi integrata mar. XL</u> • Halat chirurgical extraranforsat din material netesut ce trebuie sa fie repelent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre. • Sa aiba o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor. • Cu scămoșare redusă și rezistent la abraziune. • Cu suprapunere foarte lata la spate si cu ranforsare la piept si ranforsare completa la maneci. • Sa aiba masca integrata. • Cu manșete elastice lungi și tricotate.
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4563448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0255 486956
• e-mail: judalean@hospit.ro • www.hospit.ro



					• Cu banda de siguranță combinată, "arici" cu zone adezive, din polipropilenă lipită, pentru reglarea la gât a halatului chirurgical, pe orice porțiune din spatele gâtului. • Materialul halatului să respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. • Să fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flămăritate îmbrăcăminte textilă • Să nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu • Material: ○ Nețesut: Polipropilenă-material nețesut (SMS), care să respingă antistatic alcoolul > nivel 8 ○ Ranforsare: dublu strat laminat respirabil în zona frontală ranforsată și triplu strat laminat în zona ranforsată a manecii, repelent la alcool > nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (20) ○ Manșete - 100% Poliester ○ Fir cusătură - 100% Poliester • Mască sa aibă dimensiunea de 28 x 23 cm și să aibă siret de min 50 cm • Caracteristici în zona neranforsată: ○ Rezistență la penetrare microbiană – minim 4,2 IB ○ Puritate – microbiana – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie maxim 2,2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2,2 log 10 ○ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 36 cm H₂O ○ Rezistență la rupere – Uscat – minim 162 kPa ○ Rezistență la rupere – Umed – minim 160 kPa ○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 65 N, transversal minim 30 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 67 N, transversal minim 35 N
--	--	--	--	--	--



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal /663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0253 486956
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



						• Caracteristici in zona cu ranforsare: ○ Rezistența la penetrare microbiană minim 6 IB ○ Puritate – microbiana – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2.2 log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H₂O ○ Rezistența la rupere – Uscat – minim 215 kPa (in zona manecii)/255 kPa (in zona pieptului) ○ Rezistența la rupere – Umed – minim 198 kPa (in zona manecii)/ 250 kPa (in zona pieptului) ○ Rezistență la tracțiune – uscat: □ Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (in zona manecii) □ Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (in zona pieptului) ○ Rezistență la tracțiune – umed: □ Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (in zona manecii) □ Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (in zona pieptului) • Dimensiune: XL - lungime:150 cm, circumferința: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforsata integral) • Sa prezinte marcaj CE in conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale. <u>Specificatii electrocauter, cu 2 butoane, min. 450 cm:</u> - Electrood activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pini, compatibil cu unitatile Valley Lab, lungime cablu min. 450cm <u>Specificatii pansament postoperator cu corp absorbant si strat de</u>
--	--	--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4683443 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 488056
• e-mail: județean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



					<u>silicon:</u> • Pansament steril hidrocelular pentru protecția plagilor post-chirurgicale sau primare, cu strat siliconic, autoadeziv • Sa fie indicat pentru tratamentul rănilor postoperatorii, pentru absorbția exsudatului în cazul plagilor cu exsudat scazut pana la moderat și pansarea sterilă plagilor acute • Sa fie confecționat din material moale netesut și un corp absorbant, acoperite cu un strat de adeziv siliconic perforat • Sa fie acoperit cu un adeziv siliconic • Sa fie prevăzut cu un corp absorbant • Sa includa un strat siliconic de contact cu rana care nu are aderență cu aceasta. • Suport: Material netesut • Adeziv siliconic • Tampon plagă în trei straturi: - o stratul de contact cu plaga: plasa confecționată din polietilena, care sa previna aderența tamponului la plagă - o stratul de transmitere: confecționat din vâscoză, care sa permita exsudatelor să fie absorbite rapid - o stratul de retenție: confecționat din de fibre superabsorbante care rețin exsudatul • Strat acoperire adeziv: film protector • Adezivitate: minim 2,4 N/25 mm • Capacitate de absorbție: > 43,5g/100cm² • Capacitate de retenție a exsudatului: minim 95% • Capacitate de gestionare a fluidelor: aprox 17 g/100cm²/24h • Rata de transmisie a vaporilor de apă: min 930g/ m²/24h • Dimensiune: 15 x 8 cm (corp absorbant 11 x 3,8 cm) • Ambalare: sigilati individual in folie termosudata • Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril • Marcă CE conform Regulamentul (UE) 2017/745 privind
--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA


• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 466956
• e-mail judekian@hospital.ro • www.hospital.ro



						dispozitivele medicale (MDR)
						Sterilizare cu oxid de etilena. Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabila pentru umarirea circuitului produsului. Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR). Declaratia de Conformitate sa includa SRN (numarul unic de inregistrare) si UDI-DI (numerele de inregistrare ale dispozitivelor medicale) in EUDAMED (baza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale) Sa respecte standardele referitoare la impachetare in 4 straturi EN ISO 11607 si EN 868 (ambalaj individual steril, ambalaj de raft, ambalaj de depozit si ambalaj de transport). Valabilitate: 5 ani
10.	Kit steril unica utilizare chirurgie cerebrala	Buc	120	292	35040	<u>Continut kit:</u> 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente 150 x 190 cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayo 80 x 145 cm 1 camp neurochirurgice ranforsat 245 x 320 cm cu sac colector si folie incizie, fenestratie 19 x 30 cm 4 campuri autoadezive 50 x 50 cm 1 bandă autoadezivă 10 x 50 cm 2 șervețele de celuloză 30 x 30 cm 2 benzi Velerio 2 x 23 cm 20 comprese din material netesut cu fir radioopac in 3 straturi, culoare alba, 10 x 10 cm 1 halat chirurgical dublat mar. I. 3 halate chirurgicale extrarandforsate, cu masca cu legaturi integrata



• **Bulevardul Unirii** Rebreanu, Nr. 156 Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 466344E • Telefon +4 0356 43311 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judeleai@hospital.ro • www.hospital.ro

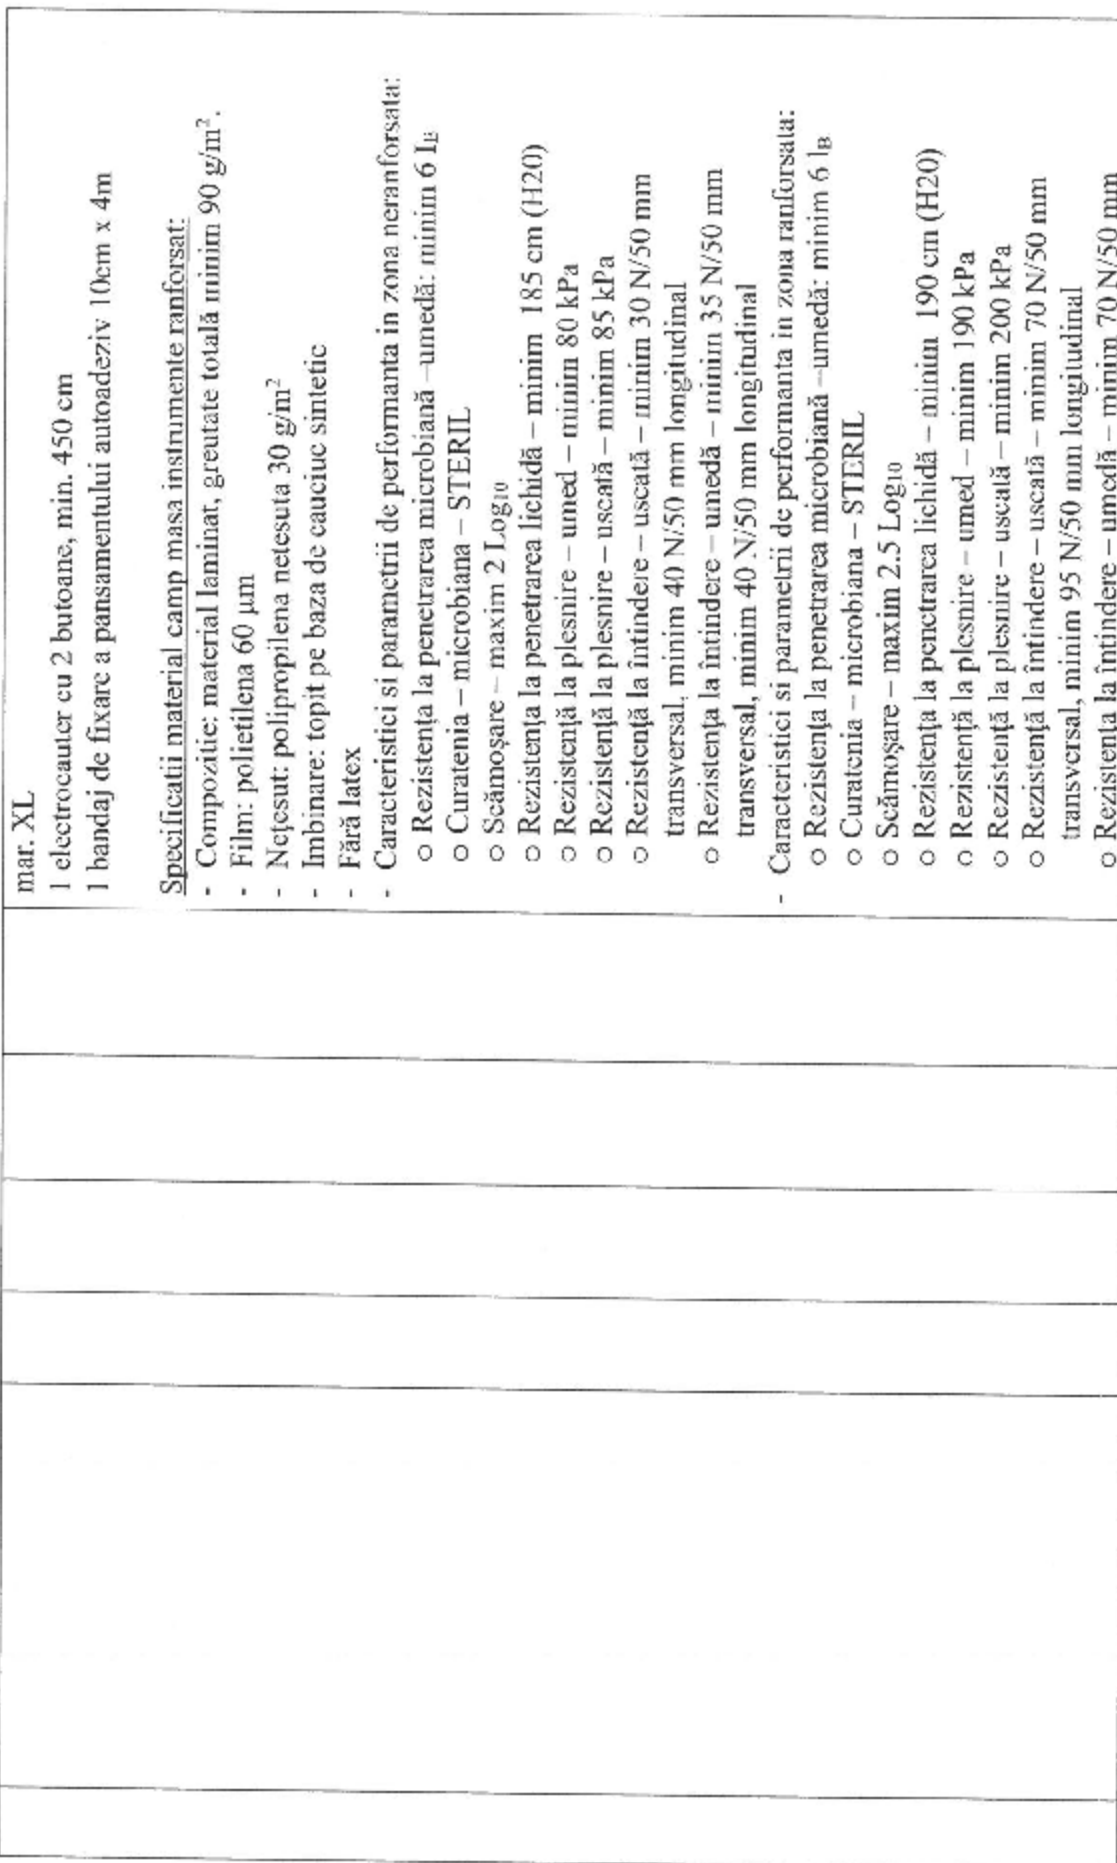




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timisoara

Cod fiscal 4053448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956

e-mail: judeleean@hospm.ro • www.hospm.ro



transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal	<u>Specificatii material camp Mayo:</u> - Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m². - Neșut: PP hidrofil, 30 g/m² - Film: polietilena 60 μm - Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic - Fără latex - Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranforsata: - o Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 lb - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 1.5 Log₁₀ - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 80 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 75 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa - o Rezistență la întindere – uscată – minim 35 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal - o Rezistența la întindere – umedă – minim 40 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal - Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsata: - o Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 lb - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa - o Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal - o Rezistența la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal
---	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 153, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486566
• e-mail: judelekar@hospit.ro • www.hospit.ro



						Specificatii material campuri bistratificate: - Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m², - Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond), minim 30 g/m² - Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate și bacterii - Cele două straturi să fie îmbinate termic - Fără latex - Caracteristici și parametrii de performanță: - o Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B - o Curatenia – microbiană – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa - o Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal - o Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal - o Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²
						Specificatii material campuri ranforsate: • Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + Absorbant- intaritura minim 55 g/m² • Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m² • Material întăritura: SMS hidrofilic nețesut • Nețesut; Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond) • Film: polietilenă compact • Straturile să fie îmbinate termic • Fără latex



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara

• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0356 403111 • Fax +4 0256 486956

• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



						• Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I B ○ Curățenia – microbiană – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2.5 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H20) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² • Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I B ○ Curățenia – microbiană – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H20) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 335 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m² Materialul câmpurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser. Câmpurile să fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR
--	--	--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: jucelbar@hospitn.ro • www.hospitn.ro



					Part 1610 referitor la flammabilitate Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germeni, să se muleze ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-stactice, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii). Cămpurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare. Specificatii comprese din material netesut cu fir radioopac: - Între două straturi de material netesut (70% vascoză și 30% polyester) să fie amplasat un strat de plasa de poliamida/polyester pentru mărirea rezistenței. - Straturile exterioare să fie încrețite pentru mărirea capacității de absorbție. - Să conțină fir radioopac cu conținut de sulfat de bariu minim 60%. - Să nu conțină: latex, PVC, plastifianți alternativi, colofonic, Clor, Bisphenol A, materii prime de origine animală, substanțe toxice. - Scamosare foarte scăzute, să nu prezinte fire desprinse. - Să prezinte ISO 10993 pentru evaluarea biologică a dispozitivelor medicale și EN ISO 14971-managementul riscului privind dispozitivele medicale. - Să fie testate în conformitate cu EN 1644-1 - o Capacitate rețenție a lichidelor să fie de min. 12 g/g, iar după 30 minute de imersare la 37 grade C, 15 g/cmp - o Dimensiune: 10 x 10cm; - o PH neutru Specificatii halat chirurgical dublat, mar. L • Halat chirurgical ranforsat din material netesut, ignifug, repelent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre; cu o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 488953
• e-mail: județean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



- Scămoșare redusă și rezistent la abraziune.
- Manșete elastice lungi și tricotate din poliester.
- Sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și parte adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice porțiune din jurul gâtului.
- Suprapunere extra largă la spate.
- Guler colorat pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție.
- Materialul halatului sa respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”.
- Zonele ranforsate sa fie repelente la alcool – minim clasa 9, NWSP 080.8.R0 (20)
- Sa fie rezistent ignifug Clasa I conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flămăritate îmbrăcăminte textilă.
- Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu.
- Material:
 - Nețesut: Polipropilenă-materiale netesut (SMS), minim 40g/m² antistatic
 - Ranforsare: material laminat din pelicula netesuta PP-PE în partea din față și pe brate, minim 42 g/m²
 - Manșete - 100% Poliester
 - Fir cusătură - 100% Poliester
- Caracteristici în zona neranforsată:
 - Rezistența la penetrare microbiană – minim 3 IB
 - Puritate – microbiana – STERIL
 - Puriitate – Particule în suspensie ≤ 2,5 IPM
 - Scămoșare – maxim 2.5 log10
 - Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 40cm H₂O
 - Rezistența la rupere – Uscat – minim 138 kPa
 - Rezistența la rupere – Umed – minim 137 kPa
 - Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 103 N.




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 480956
• e-mail: judeatean@hospin.ro • www.hospin.ro



									transversal minim 40 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 105 N, transversal minim 40 N • Caracteristici în zonele cu ranforsare: ○ Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 IB ○ Puritate microbiană – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2 log10 ○ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 160 cm H₂O ○ Rezistență la rupere – Uscat – minim 300 kPa ○ Rezistență la rupere – Umed – minim 215 kPa ○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 140 N, transversal minim 84 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 137 N, transversal minim 80 N • Dimensiune: L - lungime: 125 cm, circumferința: 157 cm (ranforsare 90 x 50cm), lungime maneca: 80 cm (ranforsare 40cm) • Sa prezinte marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale <u>Specificatii halat chirurgical extraranforsat, cu masca cu legaturi integrata mar. XL</u> • Halat chirurgical extraranforsat din material netesut ce trebuie sa fie repelent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre. • Sa aiba o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor. • Cu scămoșare redusă și rezistent la abraziune. • Cu suprapunere foarte lata la spate și cu ranforsare la piept și ranforsare completa la maneci. • Sa aiba masca integrata. • Cu manșete elastice lungi și tricotate. • Cu banda de siguranță combinată, "arici" cu zone adezive, din
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486950
• e-mail: judeleean@hospitn.ro • www.hospitn.ro



						polipropilena lipita, pentru reglarea la gat a halatului chirurgical, pe orice portiune din spatele gâtului. • Materialul halatului sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1: 2019 privind ccl mai înalt nivel de performanta „Performanta malta, zona critica”. • Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flambabilitate îmbracaminte textila • Sa nu conțina cauciuc natural din latex și nici colofoniu • Material: ○ Nețesut: Polipropilenă-material nețesut (SMS), care sa respinga antistatic alcoolul > nivel 8 ○ Ranforsare: dublu strat laminat respirabil in zona frontala ranforsata si triplu strat laminat in zona ranforsata a manecii, repelent la alcool > nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (20) ○ Manșete - 100% Poliester ○ Fir cusătură - 100% Poliester • Masca sa aiba dimensiunea de 28 x 23 cm si sa aiba siret de min 50 cm • Caracteristici in zona neranforsata: ○ Rezistența la penetrare microbiană – minim 4,2 l B ○ Puritate – microbiana – STERIL ○ Purity – Particule în suspensie maxim 2,2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2,2 log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 36 cm H₂O ○ Rezistența la rupere – Uscat – minim 162 kPa ○ Rezistența la rupere – Umed – minim 160 kPa ○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 65 N, transversal minim 30 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 67 N, transversal minim 35 N • Caracteristici in zona cu ranforsare:
--	--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 403111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



					○ Rezistența la penetrare microbiană – minim 6 l B ○ Puritate – microbiana – STERIL ○ Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM ○ Scămoșare – maxim 2,2 log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H₂O ○ Rezistența la rupere – Uscat – minim 215 kPa (în zona manecii)/255 kPa (în zona pieptului) ○ Rezistența la rupere – Umed – minim 198 kPa (în zona manecii)/ 250 kPa (în zona pieptului) ○ Rezistență la tracțiune – uscat: □ Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (în zona manecii) □ Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (în zona pieptului) ○ Rezistență la tracțiune – umed: □ Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (în zona manecii) □ Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului) • Dimensiune: XL - lungime:150 cm, circumferința: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforsata integral) • Sa prezinte marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale. <u>Specificatii electrocater, cu 2 butoane, min. 450 cm:</u> - Electrood activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pini, compatibil cu unitatile Valley Lab, lungime cablu min. 450cm <u>Specificatii bandaj de fixare a pansamentului autoadeziv:</u> • Bandaj de fixare elastic, pentru fixarea tuturor pansamentelor
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663-48 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486856
• e-mail: judelesan@hospit.ro • www.hospit.ro



						primare și secundare, atelelor, bandajelor gipsate, cateterele și canulelor (etc.), ce se poate utiliza în special la nivelul articulațiilor și părților concave și rotunde ale corpului. Sa fie indicata pentru stabilizarea mușchilor, tendoanelor, ligamentelor și articulațiilor, cu efect scăzut de imobilizare. • Sa fie ușor coeziv. • Sa fie de unică folosință. • Dimensiune: 10cm x 4m • Compozițiematerial: ○ Aprox. 43% vâscoză ○ Aprox. 20% poliamidă ○ Aprox. 37% bumbac ○ cu înveliș special • Țesătură simplă și bordură tăiată • Greutate per zonă: min. 39 g/m² • Permeabilitate la aer $\geq 1000 \text{ l/m}^2/\text{s}$ • Elongatie min. 80% • Forță de coeziune 45 +/- 25 cN/cm • Forță de deslășurare 15 – 125 cN/cm • Lungime în extensie: 400 +/- 20 cm • Capătul sa fie pliat în margine cu aprox. 1 cm Sterilizare cu oxid de etilena. Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabila pentru urmarirea circuitului produsului. Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR). Declaratia de Conformitate sa includa SRN (numarul unic de inregistrare) si UDI-DI (numerele de inregistrare ale dispozitivelor
--	--	--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4603446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@jhos-pm.ro • www.jhos-pm.ro



						medicale) in EUDAMED (baza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale) Sa respecte standardele referitoare la impachetare in 4 straturi EN ISO 11607 si EN 868 (ambalaj individual steril, ambalaj de raft, ambalaj de depozit si ambalaj de transport). Valabilitate: 5 ani
11.	Cateter monoJ 6Ch	Buc	120	120	14400	Stent Ureteral monoJ - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac; - un singur capat sa fie efilat, celalat drept - lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm; - termen implant pana la 3 luni; - Sterile; - Garantie minim 2 ani;
12.	Cateter monoJ 8Ch	Buc	120	150	18000	Stent Ureteral monoJ - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac; - un singur capat sa fie efilat, celalat drept - lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm; - termen implant pana la 3 luni; - Sterile; - Garantie minim 2 ani;
13.	Cateter monoJ 8Ch termen lung	Buc	20	350	7000	Stent Ureteral mono J - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac; - un singur capat sa fie efilat, celalat drept - lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 153, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



						- termen implant minim 6 luni; - Sterile; - Garanție minim 2 ani;
14.	Combișet steril pentru intervenții mari urologice	Buc	100	347	34700	Compus din: 1 buc CAMP PENTRU MASA DE INSTRUMENTE MINIM 190 X 150 CM RANFORSAT MINIM 75 X 190 CM 1 buc CAMP DE ACOPERIRE PENTRU MASA MAYO MINIM 80 X 145 CM 1 buc CAMP AUTOADEZIV BISTRATIFICAT MINIM 240 X 150 CM 2 buc CAMP AUTOADEZIV BISTRATIFICAT MINIM 90 X 75 CM 1 buc CAMP AUTOADEZIV BISTRATIFICAT MINIM 175 X 170 CM 1 buc HALAT EXTRADUBLAT MAR. L, LUNGIME MINIM 130CM, CIRCUMFERINȚA MINIM 160CM, RANFORSARE 85 X 70CM, LUNGIME MANECA MINIM 77CM (RANFORSATA INTEGRAL) 2 buc HALAT EXTRADUBLAT MAR. XL, LUNGIME MINIM 150CM, CIRCUMFERINȚA MINIM 170CM, RANFORSARE 105 X 70CM, LUNGIME MANECA MINIM 88CM (RANFORSATA INTEGRAL) 2 buc BISTURIU NR. 20 1 buc BUZUNAR AUTOADEZIV CU 2 COMPARTIMENTE, PE TRANSPARENT, MIN. 46 X 40 CM 1 buc ELECTROCAUTER, CU 2 BUTOANE, MIN. 450 CM 1 buc ACCESORIU PENTRU CURĂȚAREA VARFULUI ELECTROCAUTERULUI, RADIOOPAC 5 X 5 CM 30 buc COMPRESE DIN TIFON CU FIR RADIOOPAC IN



- Bulevardul Lavinia Răduanu, Nr. 156, Cod Postal 3600723 Timișoara
- Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 4889556
- e-mail: info@harsdm.ro • www.harsdm.ro



MINIM 16 STRATURI, MIN. 17 FIRE, CULOARE ALBA, 10 X 10 CM	6 buc TAMPOANE TIFON NR. 4 (OU)	Specificatii camp masa instrumente:
1 buc PANSAMENT POST OPERATOR SUPERABSORBANT CU STRAT DE SILICON, MIN. 10 X 20 CM	1 buc BOL DIN PLASTIC 9,2 CM, GRADAT, ALBASTRU 250 ML	- Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu se dezlipi, greutate minim 90 g/m ² .
1 buc BOL DIN PLASTIC 9,3 CM, GRADAT, TRANSPARENT 250 ML	1 buc BOL DIN PLASTIC 11,5 CM, GRADAT, TRANSPARENT 500 ML	- Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germeni
1 buc TAVITA PENTRU ACE SI LAME DE BISTURIU, 10 X 5 X 1 CM CU 10 LOCURI	1 buc PENSĂ DE PLASTIC PENTRU DEZINFECTARE ZONA OPERATORIE 24 CM	- Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810-1:2005 si ISO 11810-2:2007 - rezistenta la laser.
1 buc BANDA ADEZIVA 10 X 50 CM	4 buc SERVETELE DE CELULOZA 30 X 30 CM	- Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate
		- Se vor prezenta rapoarte /confirmari de testare, original si traducere autorizata in lb romana
		Specificatii campuri bistratificate:
		Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu se




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4563448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 4869568
• e-mail lulelean@hospit.ro • www.hospit.ro



- Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germeni
- Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 -1:2005 si ISO 11810-2:2007 referitor la rezistenta la laser.
- Câmpurile sa fie clasificate in clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flămăritate
- Se vor prezenta rapoarte /confirmari de testare , original si traducere autorizata in lb romana

Specificatii halate extra dublate:

- halate chirurgicale din material nețesut, ignifuge, impermeabile pentru lichide, permeabile pentru aer, cu mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor, cu o scădere redusă și rezistent la abraziune.
 - ranforsare: dublu strat laminat respirabil în zona frontală ranforsată și triplu strat laminat în zona ranforsată a manecii
 - halatul are sistem de prindere cu snur și carton de ghidaj
 - cu manșete elastice
 - cu suprapunere foarte lărgă la spate și cu ranforsare la piept și ranforsare completă la maneci
 - să fie rezistent ignifug clasa I conform 16 CFR Part 1610 - standard pentru flămăritate îmbrăcăminte textilă
 - dimensiuni: L - lungime: 130 cm, circumferință: 160 cm (ranforsare 85 x 70cm), lungime manecă: 77 cm (ranforsată integral) XL - lungime: 150 cm, circumferință: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), lungime manecă: 88 cm (ranforsată integral)
- Specificatii bisturii:
- lama bisturiu din oțel-carbon cu maner de plastic și capac transparent detașabil pentru lama, nr. 20.




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 500723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelectr@hospitn.ro • www.hospitn.ro



						Specificatii electrocauter: - electrod activ bipolar compatibil cu electrocauterle Valley Lab, cu 2 butoane, 3 poli, lungime cablu min. 250 cm, in suport din plastic alb, sau echivalent Specificatii comprese cu fir radioopac: - comprese sterile, din tifon, cu fir colorat radioopac intretesut - sa nu lase scame, fara margini libere. - material component: bumbac pur 100% cu fir masa medie: minim 23gr/mp - rezistente la rupere Specificatii tamponac tifon: - material component: bumbac pur 100%, - densitatea de lungime: min. 20 fire - masa medie: minim 27gr/mp - sa nu lase scame - rezistente la rupere Specificatii pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon - pansament super-absorbant care sa fie indicat pentru tratamentul plăgilor cu un nivel de exsudat moderat până la abundent: plăgi acute - sa fie steril, de unică folosință, - sa fie prevăzută cu un strat de contact cu plaga din silicon, care sa permita o aplicare facilă si îndepărtarea nedureroasă, atraumatică. - se compune dintr-un corp absorbant din celuloză si un poliacrilat superabsorbant pentru absorbtia si retentia exudatului. - pe suprafața dinspre plagă sa fie prevăzută cu un strat de contact cu plaga din plasă fină de silicon care sa faciliteze aplicarea pansamentului si sa previna aderarea de plagă. - stratul de suport al pansamentului sa fie realizat dintr-un material
--	--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663446 • Telefon ++4 0356 433111 • Fax +4 0256 466056
• e-mail: judeleac@hospitn.ro • www.hospitn.ro



						netesut din polipropilenă verde, hidrofob. In acelasi timp trebuie sa fie si permeabil la aer. - sa fie ambalat individual in punga termosudata din hartie Specificatii lavita pentru ace si lame bisturiu: - Tavita din plastic, special pentru a asigura indepartarea in siguranta a obiectelor ascute, lame de bisturiu si ace. Toate componentele sa fie ambalate in acelasi pachet, steril, fiind impachetate in campul pentru masa de instrumente. Ambalajul individual are inscriptiionate: codul produsului, valabilitatea, mod de sterilizare, marca CE, producatorul. Sa prezinte pe ambalaj eticheta dubla autoadeziva, detasabila, pentru urmarirea circuitului produsului Produsele sa poarte marcaj CE Valabilitate: minim 3 ani de la data producerii si diferenta intre data producerii si a alivrari sa nu fie mai mare de 6 luni
15.	Ansa rezectie bipolara tip bucla	Buc	130	450	58500	Ansa de unicafolosinta, sterila, compatibil cu rezectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , marcaj CE, sterile




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



16.	Lama uretrotom Otis (cutit clasic drept pt uretrotomie Otis)	Buc	4	600	2400	-compatibil cu uretrotomul Otis STORZ, marcaj CE
17.	Ansa Rezecție bipolară tip Colings	Buc	6	450	2700	De unica folosință sterilă, compatibilă cu rezectoscopul bipolar STORZ 24Ch și 26Ch, marcaj CE
18.	Ansa bipolară pentru hemostază tip bila	Buc	10	390	3900	De unica folosință sterilă, compatibil cu rezectoscopul bipolar STORZ 24Ch și 26Ch, marcaj CE
19.	Cateter (sonda) ureteral cu balonas	Buc	10	1000	10000	Cateter ureteral cu balonas pentru ocluzie ureterală, trecere atraumatică, radiopac, varf deschis, 70 cm lungime. Varf drept efilat. Balonasul se umflă simetric în toate direcțiile și are capacitatea de maxim 1-3 ml. După dezumflare, acesta revine la dimensiunile inițiale ale sondei. Grosime 5 CH sau 6 CH sau 7 CH Ambalat steril, marcaj CE.
20.	Sistem de ghidaj de unica folosință pt transducere transrectal	Buc	24	102.95	2470.8	- Ghiduri de caec endocative de unică folosință pentru utilizarea cu sonda Philips C10-4 ghidaj steril pentru ac endocavitare cu 2 huse din latex de 20 cm (0.8"x 7.9"), huse din latex de 3.5 x 20 cm (1,4 " x 7.9 "), inel O de 1.3 cm (0.5 ") , accepta instrumente 16-22 GA - Ambalaj individual, steril, termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării

La toate materialele sanitare din loturile de mai sus solicităm mostre.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hosptin.ro • www.hosptin.ro



3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor/deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeați și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.


Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzută astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și de pozitionare în locul de destinație. În stabilirea nămirii și greutatei ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absența a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: sediul autorității contractante, respective Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara

• Cod Fiscal 4863446 • Telefon +4 0256 403111 • Fax +4 0256 486966

• e-mail: județean@hospital.ro • www.hospital.ro



Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul greșit al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invocă nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducătorii unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.


Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea acestora cu cea prevăzută în Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii/Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezolva rezilia contractuală atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul sau s înmânș în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factură în premie cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300722 Timișoara

• Cod fiscal 4853448 • Telefon +4 0356 433-11 • Fax +4 0256 485956

• e-mail: judefean@hospim.ro • www.hospim.ro



Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite în prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia a fost adjudicat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobărilor și standardelor tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că si Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră calcată din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi în uniune solidară responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil în scopul realizării Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru asigurarea, în mod continuu, personalului, echipamentelor și suportului necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate în Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.


Contractantul se obligă să emita facturi aferente produselor furnizate în prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea tehnică. Totodată, este responsabil de asigurarea tuturor operațiilor și metodelor de presare, cat și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă a il de către o altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300729 Timișoara
• Cod fiscal 4603446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 480858
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (*dacaestecazu*) ; raport privind testarea (*dacaestecazu*) .

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractanți și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitate și calitate solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș.

6 Modalități și condiții de plată


Contractantul va emite facturi pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți facturile și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție calitativă;
- e) documentația de utilizare (*dacaestecazu*) ;
- f) raport privind testarea (*dacaestecazu*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată aflate de părțile în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal: 300723 Timișoara

• Cod fiscal 4603448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 488966

• e-mail: judeleean@hospit.ro • www.hospit.ro



7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devine Contractant are obligația de a respecta executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acordurile colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respective conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atașate documentației de atribuire.


9 DISPOZIȚII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singur bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de parametri tehnici care trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara

• Cod fiscal 4683448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 466326

• e-mail: judeleatn@hospitn.ro • www.hospitn.ro



favorizarea eliminării anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având menținerea de „saucchivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerile tehnice presupun asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și finanțare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică a ferentăi va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Întocmit:

